

## Listado Oficial de Implantes (LOI)

Usted ha ingresado al **LOI** donde deberá cargar los implantes incluidos en el “Listado Oficial de Implantes Liberados para su comercialización y uso” creado por Disposición Anmat N° 0539/12:

- a) Implantes mamarios,
- b) Prótesis de cadera,
- c) Prótesis de rodilla
- d) Implantes de columna vertebral.

Para la carga de los productos deberá ingresar al sistema con su usuario y clave del sistema de consulta de expedientes. En caso de no tenerla deberá solicitarla en:

[http://www.anmat.gov.ar/webanmat/servicios/consulta\\_web.asp](http://www.anmat.gov.ar/webanmat/servicios/consulta_web.asp)

Ingresará a la siguiente pantalla, en la que encontrará previamente cargados los datos identificatorios de la empresa y en una grilla los productos registrados que se encuentran en la base de datos de tecnología médica:



**Listado Oficial de Implantes Liberados para su Comercialización y Uso**

**1. EMPRESA**

Empresa: PRODUCTOS CUIT: 30-52 -0

**2. PRODUCTOS**

PM:

Nombre Descriptivo:

Marca:

Modelo:

Presentación:  Estéril  No estéril  Lote  Serie

Fecha de vencimiento del producto:

Número:

Cantidad Liberada en Unidades:

Fecha de Liberación:

Origen:  Nacional  Importado

**PRODUCTOS**

legaj	PM	Nombre Descriptivo	Marca	Modelo	estac
		Reactivo para Diagnostico	Elecsys	IL6, IL6 CalSet, PreciCon	P
		Reactivo para Diagnostico	LACT2 cobas c 111	Lactate Gen2	P
		Reactivo para Diagnostico	CONFIRM	antiS100 (Ployclonal) Pir	P
		Reactivo para Diagnostico	CHED2	CholinesteraseDibucaine	A
		Reactivo para Diagnostico	CRPLX cobas c 111	Creative Protein (Latex)	A
		Reactivo para Diagnostico	AMYL2 cobas c 111	alfaAmylase EPS ver2	A
		Reactivo para Diagnostico	CHOL2	Cholesterol Gen2	A
		Aparato para autoevaluacion	AccuChek	Go	A
		Reactivo para Diagnostico d	CONFIRM	antiProstate Specific Anti	P
		Reactivo para Diagnostico	Elecsys	TSH, TSH Calset, PreciCo	A
		Reactivo para Diagnostico	Roche CARDIAC	M Myoglobin, Control My	P
		Reactivo para Diagnostico	PHOS2 cobas c 111	Phosphate (inorganic) ve	P
		Reactivo para Diagnostico	CHE2	Cholinesterase Gen2	A
		Analizador Hematologico	Symex	XE2100D	A

Fabricante:  Dirección:

Origen:

Para realizar la carga de productos deberá:

- 1) Seleccionar de los productos listados en la grilla el producto a cargar para su liberación y el fabricante correspondiente. Una vez seleccionado aparecerán en la pantalla los datos característicos del producto: número de PM, Nombre descriptivo, Marca y Modelo.



The screenshot shows a web application interface with the following sections:

- 1.- EMPRESA:** Includes fields for 'Empresa' (set to 'PRODUCTOS'), 'CUTI' (set to '30-52'), and a '0' button.
- 2.- PRODUCTOS:** Contains input fields for 'PM' (71, 2), 'Nombre Descriptivo' (Reactivo para Diagnostico de Uso), 'Marca' (Elecsys), and 'Modelo' (IL6, IL6 CalSet, PreciControl IL6).
- Presentacion:** Radio buttons for 'Estéril' (selected), 'No estéril', 'Lote', and 'Serie'.
- Origen:** Radio buttons for 'Nacional' (selected) and 'Importado'.
- Fecha de vencimiento del producto:** A date selection field.
- Número:** A text input field.
- Cantidad Liberada en Unidades:** A text input field.
- Fecha de Liberación:** A date selection field.
- Agregar Lote / Serie:** A button.
- PRODUCTOS TABLE:** A table with columns: 'legaj', 'PM', 'Nombre Descriptivo', 'Marca', 'Modelo', and 'estac'. It lists various diagnostic reagents and equipment.
- Fabricante:** A dropdown menu set to 'seleccione'.
- Dirección:** A text input field.
- Origen:** A text input field.
- Buttons at the bottom:** 'Incorporar producto al anexo', 'NUEVO PRODUCTO', 'VER ANEXO', 'ENVIAR', 'Subir PDF', and 'SALIR'.


- 2) En caso de que el producto no se encuentre listado en la grilla, o que falte alguno de los datos identificatorios del mismo deberá:

- Seleccionar la opción de Nuevo Producto que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.



The buttons shown are: 'Incorporar producto al anexo', 'NUEVO PRODUCTO', 'VER ANEXO', 'ENVIAR', 'Subir PDF', and 'SALIR'.


- Cargar los datos identificatorios correspondientes, según la Disposición Autorizante del producto.



- Una vez concluida la carga, seleccionar la opción Incorporar a Grilla que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Una vez terminada la carga deberá continuar según lo indicado en 1)

Cuando el producto aparece identificado en la pantalla de carga deberá completar los siguientes datos específicos:




legajo	PM	Nombre Descriptivo	Marca	Modelo
		Aparato para Autoevaluación	AccuChek	Performa Combo
		Dispositivo de Punción (Port)	AccuChek	Softclix, Softclix Lancet, So
		Reactivo para Diagnóstico de	MG2	Magnesium Gen2
		Reactivo para Diagnóstico de	HCY Partner Channel	Diazyme Homocysteine Eni
		Sistema para Tinción Autom	BenchMark	BenchMark GX, BenchMark
		Reactivos para Diagnóstico de	DDI2	Tinaquant DDimer Gen2, C
		Reactivos para Diagnóstico de	FERR4	Tinaquant Ferritin Gen4
		Analizador para Pruebas de	CoaguChek	XS Pro
		Reactivo para Diagnóstico de	HBALC III	Tinaquant Hemoglobin A1c
		Reactivo para Diagnóstico de	FRA	Fructosamine
		Reactivo para Diagnóstico de	LACT2	Lactate Gen2
		Reactivo para Diagnóstico de	PREA	Prealbumin
		prueba je 985	marca je 985	modelo je 985
		ZZZ	ZZZZ	Z


- a) Seleccionar si se trata de un producto estéril o no estéril. Si se trata de un producto estéril, deberá indicar la fecha de vencimiento en el campo indicado.
- b) Seleccionar si el producto a cargar posee número de lote o serie.
- c) Ingresar el número de Lote / Serie según corresponda.
- d) Ingresar el número de unidades que se liberan. En caso de tratarse de número de serie sólo se permite 1 unidad.
- e) Ingresar la fecha de liberación de los productos cargados.
- f) Seleccionar si se trata de un producto nacional o importado.

Una vez finalizado con la opción Agregar Lote / Serie () podrá cargar únicamente los datos de Lote / Serie, unidades liberadas y fecha de liberación manteniendo los datos identificatorios del producto de la última carga

- g) Seleccionar “incorporar producto al anexo”. Con esta opción, los datos cargados pasarán a formar parte del Anexo
- h) Seleccionar “subir pdf”. Esta opción le permitirá adjuntar los archivos pdf firmados digitalmente, necesarios para verificar los datos característicos de los productos a ingresar:
  - Si se trata de un modelo registrado por Disp. Anmat N° 2318/02 deberá adjuntar el archivo correspondiente a la Disposición de registro.
  - Si se trata de un modelo empadronado deberá adjuntar el archivo del empadronamiento. En este caso, el sistema le solicitará que ingrese el número de expediente mediante el cual se inicio el registro correspondiente.

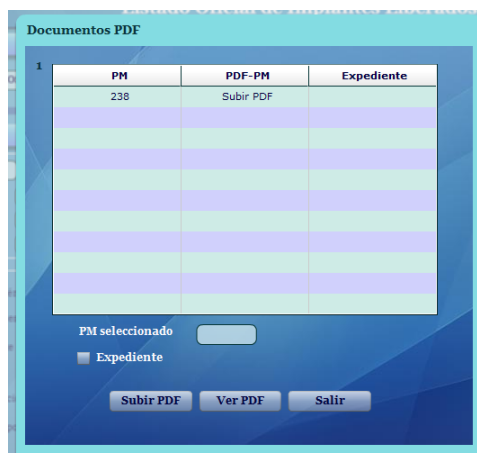

Debera seleccionar el ítem y presionar “Subir PDF”

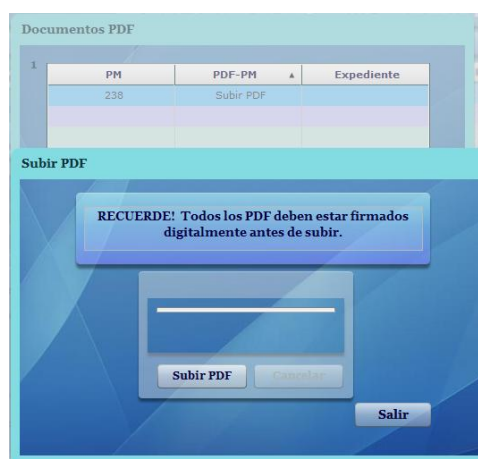

Una vez finalizado con la opción Agregar Lote / Serie ( **Agregar Lote / Serie** ) podrá cargar únicamente los datos de Lote / Serie, unidades liberadas y fecha de liberación manteniendo los datos identificatorios del producto de la última carga.

En la opción Ver Anexo ( **VER ANEXO** ) podrá visualizar los productos cargados. Desde esta pantalla tendrá la opción de Editar o Borrar, posicionándose sobre el ítem a ser tratado.

